



Safiltco Kft

**GÁZANALITIKAI
VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUM**



www.Safiltco.com

SZOLGÁLTATÁSAINK többek között:

- ◆ Laboratóriumi mérés, kísérlet
- ◆ Terepi mérés, mintavételezés
- ◆ Abszorber, adszorber helyszíni vizsgálat
- ◆ Kalibrálás
- ◆ Oktatás
- ◆ Bérbeadás
- ◆ Szerviz

MÉRÉSI TERÜLETEINK:

- ◆ Emisszió mérés
- ◆ Munkahelyi légtér összetétel mérés
- ◆ Gázálarc betét egyedi vizsgálata
- ◆ Védőruha vizsgálat

HAGYOMÁNYOS EMISSZIÓ MÉRÉS

- ◆ Mintavétel – aktívszén
- ◆ Minta leoldása az aktívszénről
- ◆ Minta elemzése
- ◆ Koncentráció számítása
 - Összességében 10 – 30% hibahatárral

MIT AJÁNLUNK

◆ Gázelemzés FT-IR-rel




◆ Real-time adatmegjelenítés

[illegible]


ELŐNYEI

◆ Trend mutatója

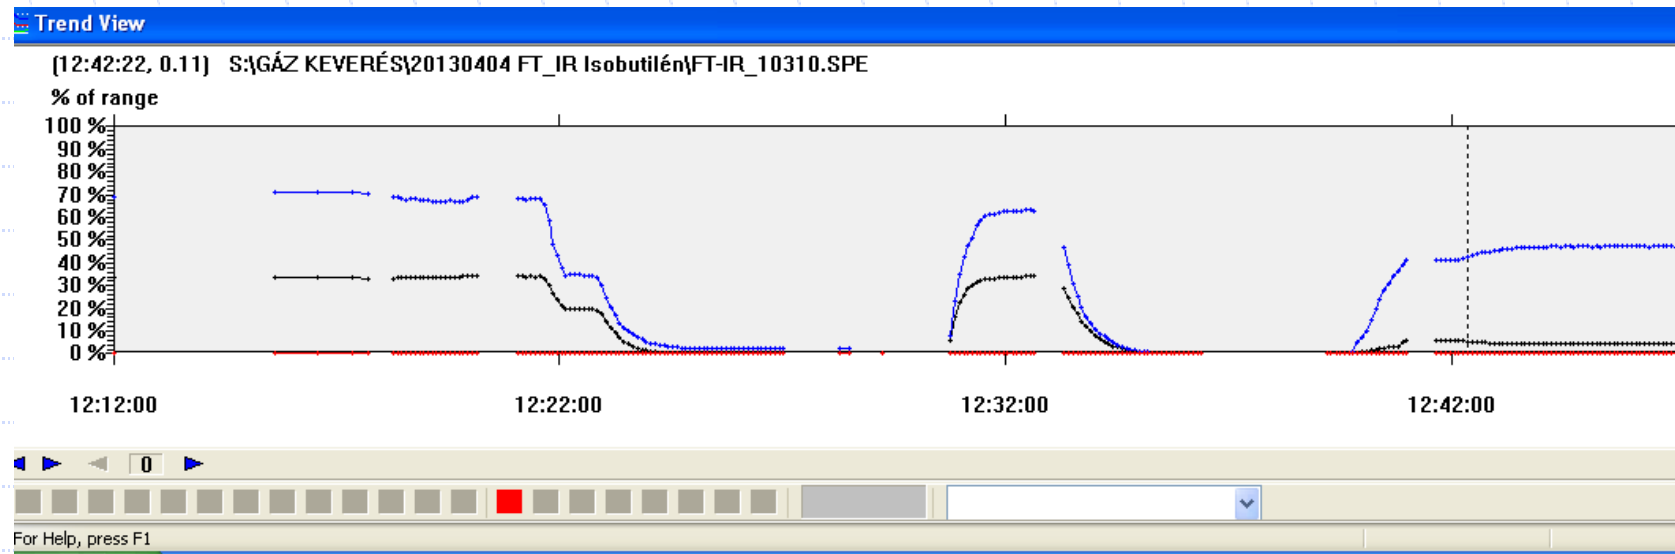


ELŐNYEI

◆ Trendek elemzése komponensenként

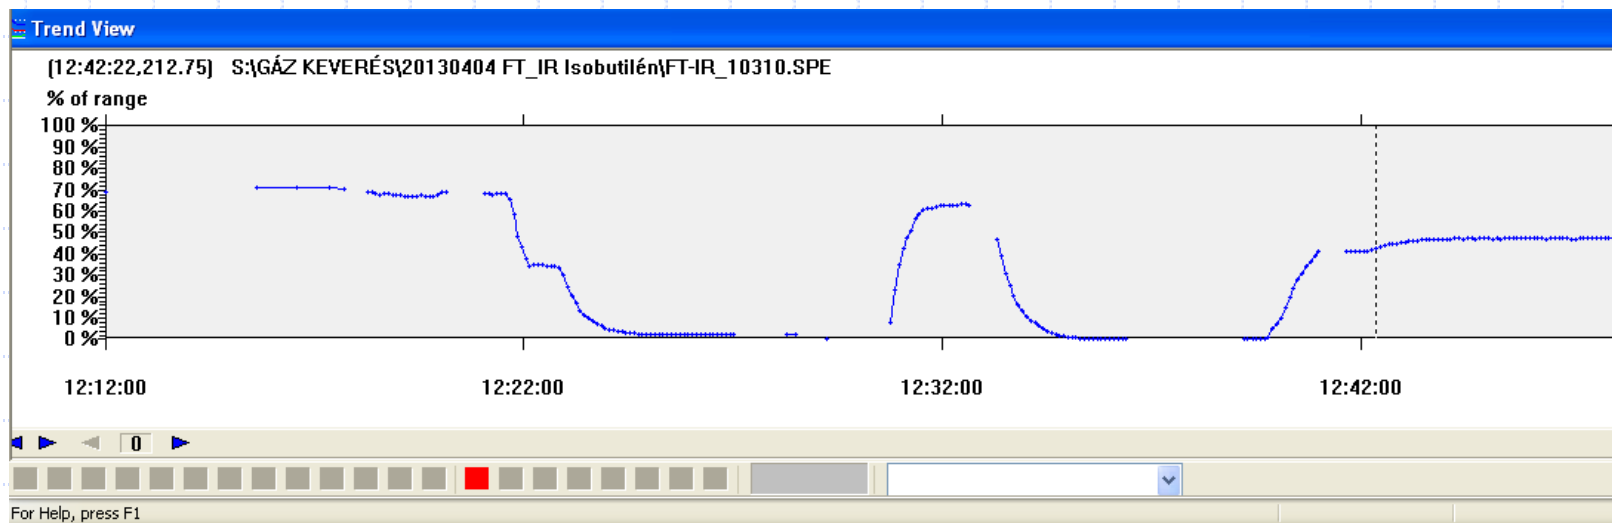


ELŐNYEI

◆ Adatok archiválása, visszakereshetősége

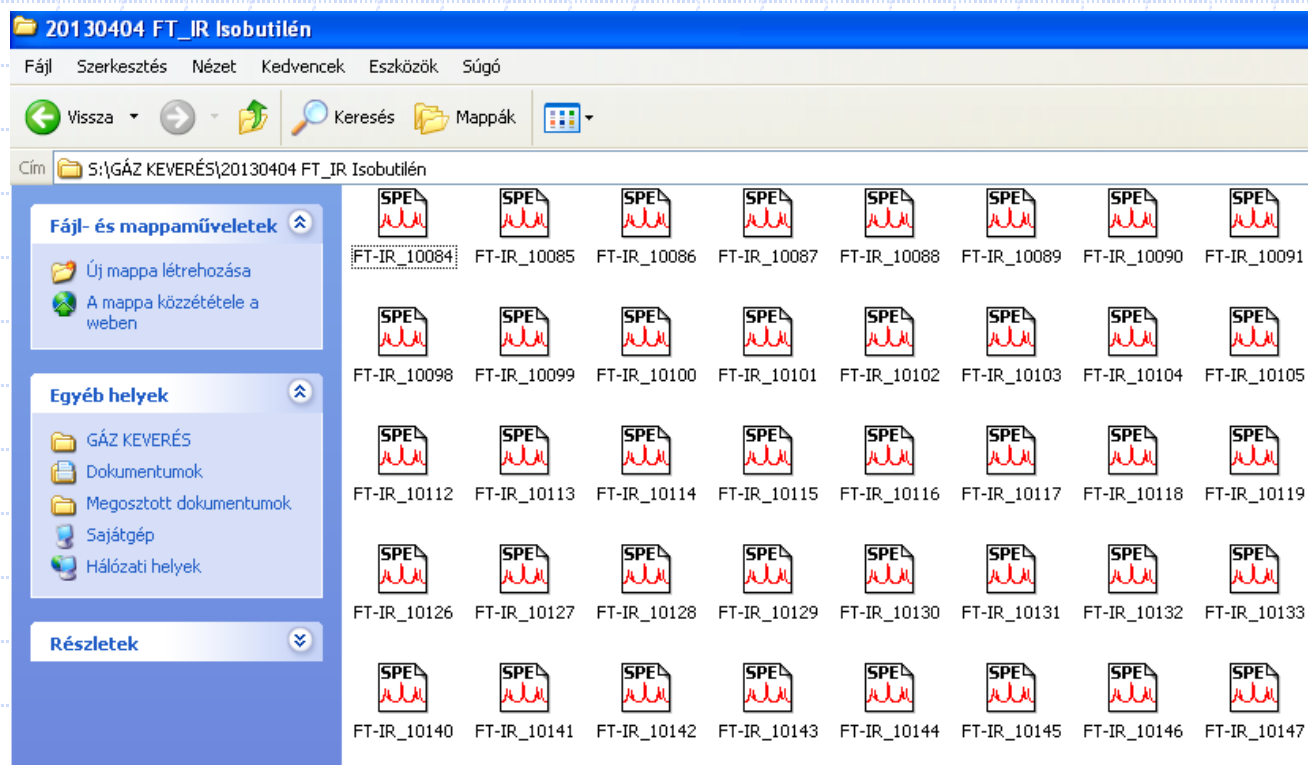

ELŐNYEI

◆ Exportálás txt, és innen xls fájlba

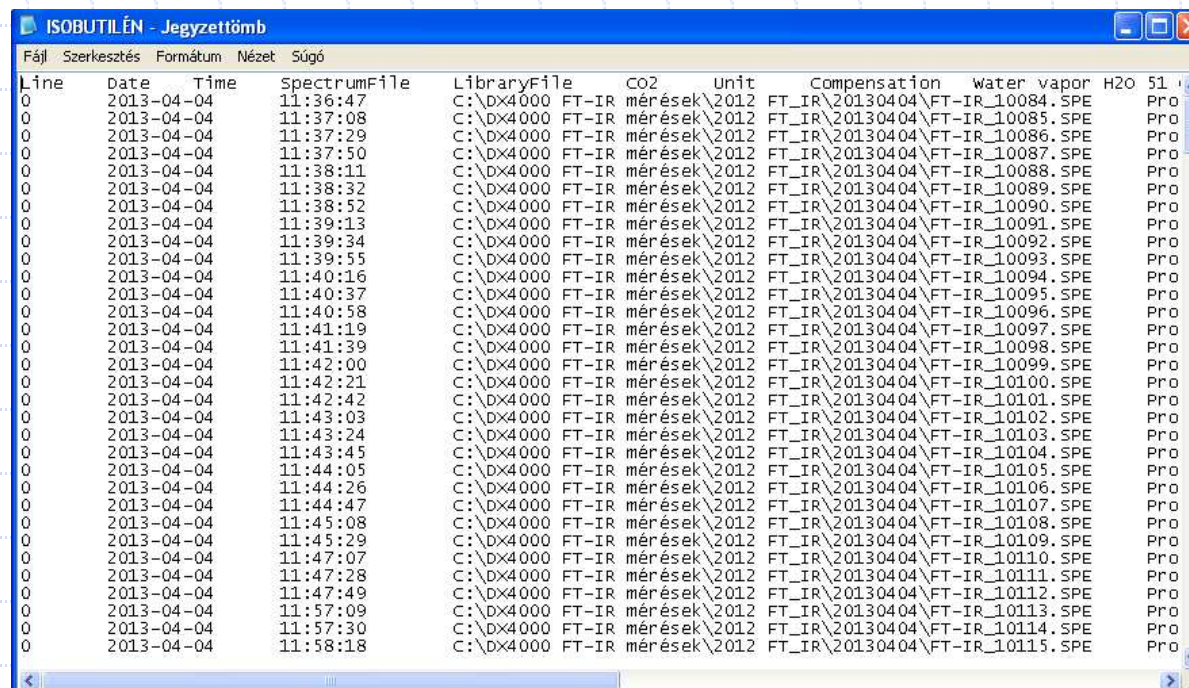

The screenshot shows a software window titled "ISOBTILÉN - Jegyzetkönyv" with a menu bar (Fájl, Szerkesztés, Formátum, Nézet, Súgó). The main area displays a table of measurement data with columns: Line, Date, Time, SpectrumFile, LibraryFile, CO2, Unit, Compensation, Water vapor, and H2O. The data consists of 20 rows, each representing a measurement taken on 2013-04-04 at various times. The SpectrumFile and LibraryFile columns contain file paths, and the CO2 column shows values like "mérések\2012". The Unit column is empty, and the Compensation and Water vapor columns contain file paths. The H2O column shows values like "Pro".

Line	Date	Time	SpectrumFile	LibraryFile	CO2	Unit	Compensation	Water vapor	H2O
0	2013-04-04	11:36:47	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10084.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:37:08	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10085.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:37:29	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10086.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:37:50	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10087.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:38:11	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10088.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:38:32	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10089.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:38:52	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10090.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:39:13	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10091.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:39:34	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10092.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:39:55	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10093.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:40:16	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10094.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:40:37	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10095.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:40:58	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10096.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:41:19	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10097.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:41:39	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10098.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:42:00	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10099.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:42:21	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10100.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:42:42	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10101.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:43:03	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10102.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:43:24	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10103.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:43:45	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10104.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:44:05	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10105.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:44:26	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10106.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:44:47	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10107.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:45:08	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10108.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:45:29	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10109.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:47:07	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10110.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:47:28	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10111.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:47:49	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10112.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:57:09	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10113.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:57:30	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10114.SPE				Pro
0	2013-04-04	11:58:18	C:\DX4000	FT-IR mérések\2012	FT_IR\20130404\FT-IR_10115.SPE				Pro

MÉRHETŐ KOMPONENSEK

- ◆ Szerves gázok, gőzök
- ◆ Szervetlen gázok, gőzök
- ◆ Minden, ami IR aktív

MÉRÉSI TARTOMÁNY

- ◆ Alsó határérték: ~ 1 ppm
- ◆ Felső érték: 100 %

EGYÉB MŰSZEREINK

◆ RS 53-T FID össz szénhidrogén mérő



KÉZI MŰSZEREINK


◆ **ppbRAE3000**
PID VOC mérés



◆ **MiniRAE3000**
PID VOC mérés



ELÉRHETŐSÉGÜNK

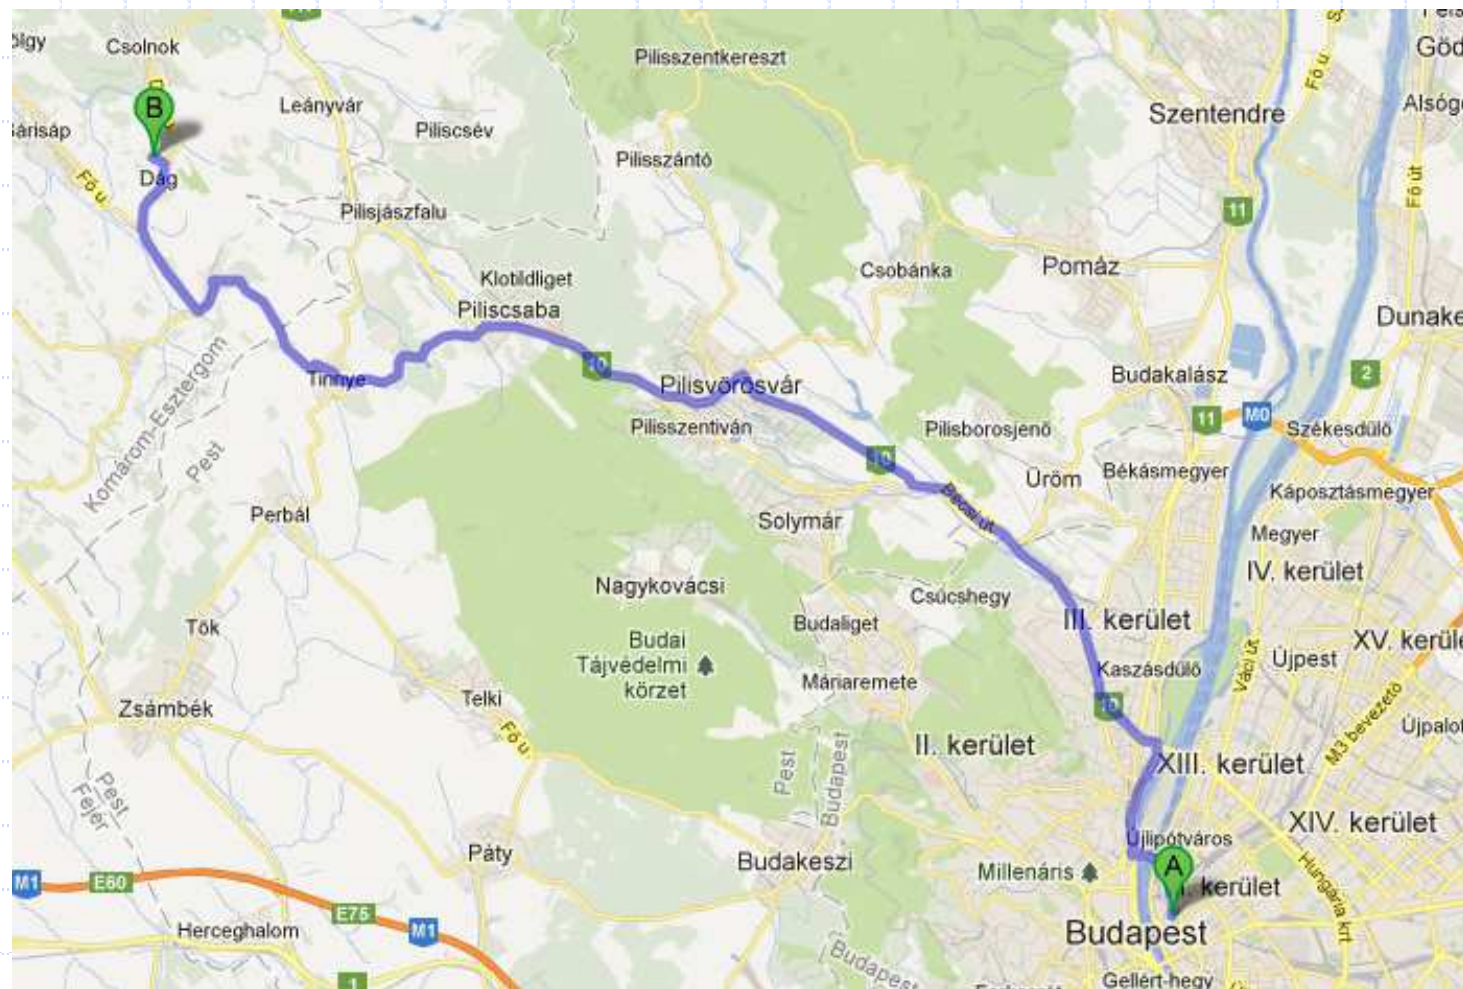

ELÉRHETŐSÉGÜNK

- ◆ 2522 DÁG, SÁGVÁRI u. hrsz. 750
- ◆ +36209578184
- ◆ bagi@safiltco.com
- ◆ www.safiltco.com

**REMÉLJÜK,
RÖVIDESEN
PARTNEREINK KÖZÖTT
KÖSZÖNTHETJÜK**